

Białystok, dnia 11.01.2023r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny ZOZ
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.68.2.2022

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawa materiałów medycznych na Blok Operacyjny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.68.2022.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1:

Dotyczy pakietu nr 1

Punkt nr 17. Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie do zaoferowania włącznika nożnego 2-przyciskowego z kablem o dl. 5m i wtykiem 6pin oraz możliwości zaoferowania zamiast włącznika z wtykiem 4-pin włącznika z wtykiem 6pin oraz adapterem, ponieważ włącznik nożny z wtykiem 4 pin został wycofany z produkcji

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 6:

1. Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji tarczycy zgodnego z SWZ z tą różnicą, że otwór samoprzylepny w serwecie głównej ma kształt rombu i wymiar 13 x 13 cm oraz dodatkowy pad chłonny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Zadanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm


1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 190 cm x 225 cm

serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 250 cm z wycięciem "U" 10 x 65 cm serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

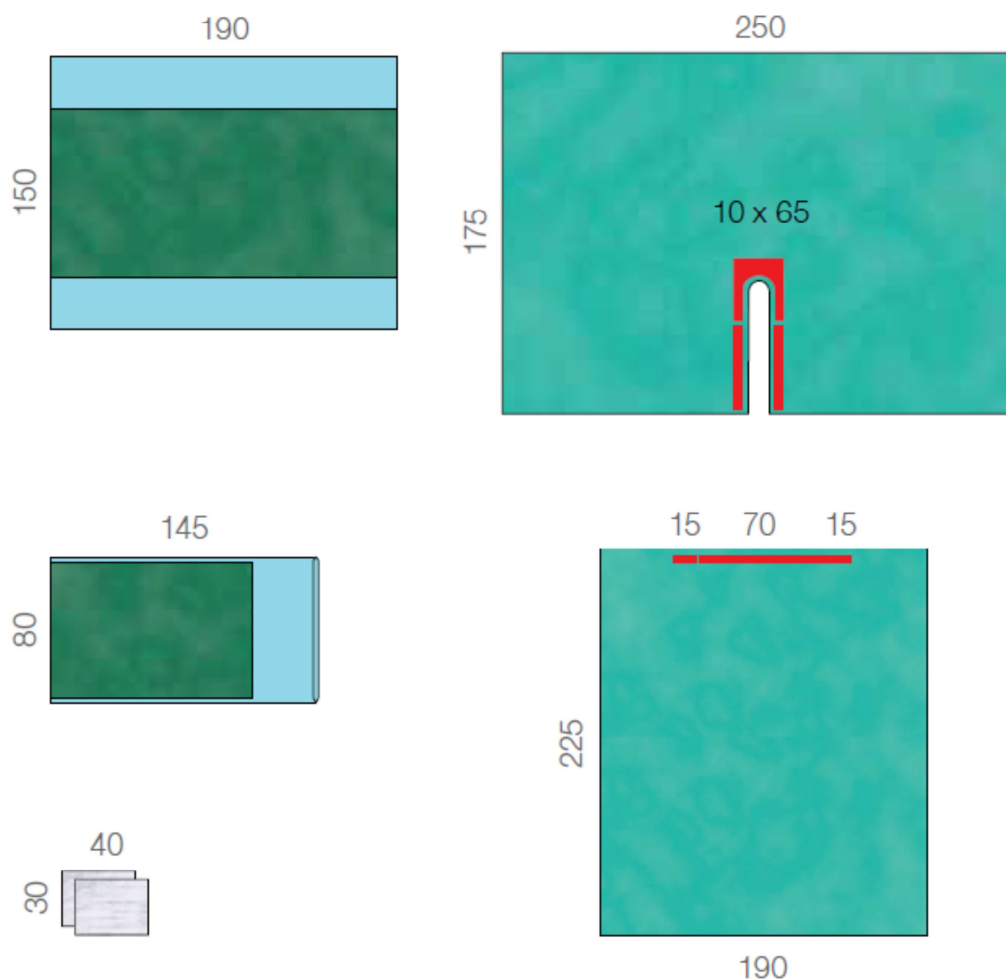

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do operacji tarczycy, o niewiele różniących się parametrach jak poniżej:

Sterylnego zestawu do operacji tarczycy. Skład zestawu:

1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log₁₀) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200 cm H₂O. Materiał o dużej odporności na rozierwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą **jednorodna, mata antypoślizgowa** na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody.


1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej 75x190cm +/- 1cm.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym min. 2 etykiety zawierające kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², o składzie:


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

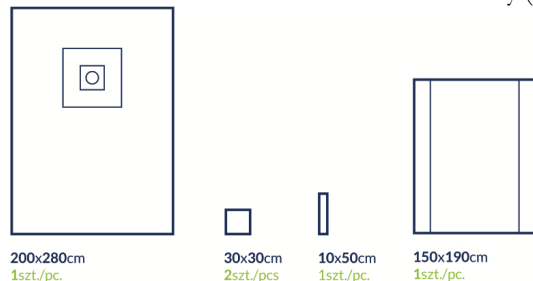

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

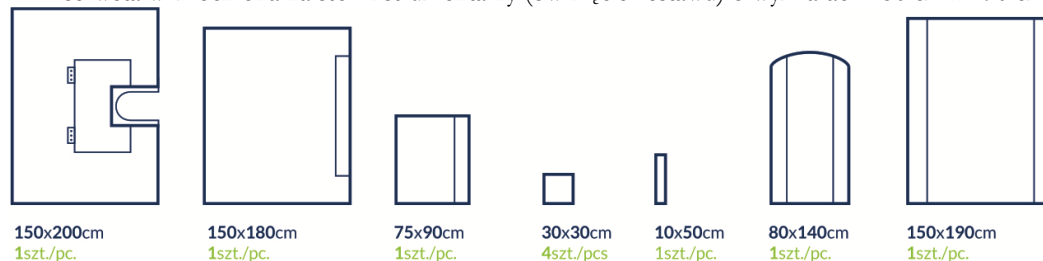

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8:

1. Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia zza granicy i nie są lekami ratującymi życie oraz na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania nr 8 do 20 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

ZMIANA SWZ w zakresie Rozdziału 23:

W związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulegają zapisy Rozdziału 23 „Opis kryterium oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów sposobu obliczenia ofert” w poniższym zakresie:

Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:

Dotyczy: Pakietów nr:
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45

Zaoferowany termin dostawy (dni roboczych)	Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni	0 pkt
4 dni	20 pkt
3 dni	40 pkt

Dotyczy: Pakietów nr: 1, 7, 8, 17, 21, 22, 24

Zaoferowany termin dostawy (dni roboczych)	Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
14 dni	0 pkt
12 dni	20 pkt
10 dni	40 pkt

Dotyczy: Pakietu nr 8

Zaoferowany termin dostawy (dni roboczych)	Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
20 dni	0 pkt
18 dni	20 pkt
16 dni	40 pkt

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni/10 dni/16 dni i nie dłuższy niż 5 dni/14 dni/20 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia (określone powyżej dla poszczególnych pakietów).

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze/14 dni robocze/ 20 dni robocze (określone powyżej dla poszczególnych pakietów).“

Pozostałe zapisy Rozdziału 23 pozostają bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 9:

Pakiet 9 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z matą chłonną na stół operacyjny wykonaną w części spodniej z folii PE i wierzchniej z włókniny polipropylenowej posiadającą w części środkowej absorbent umożliwiający trwale zatrzymanie płynu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 9 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z ręcznikiem chłonnym o gramaturze 56g/m², zamiast 40g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 10:

Pakiet 10

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pościeli:

Pościel medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m², kolor biały. Komplet zawiera: poszewkę na poduszkę 70x80 cm, poszewkę na koldrę 200x140 cm, prześcieradło 240x140 cm. Wyrób medyczny klasy I.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2-4

Prosimy o dopuszczenie pościeli o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200 x 140

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 200 x 160

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bluzy operacyjnej o poniższych parametrach:

Bluza operacyjna rozpinana z dlugim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS (polipropylenowej) o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony dzianinowym mankietem. Dostępny w rozmiarach S, M, L, XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego:

Jednorazowy, biały koc do przykrycia pacjenta z możliwością podgrzania do 60 stopni wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m² (warstwa zewnętrzna) i poliestrowego wypełnienia o gramaturze 88g/m², z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów warstw. Szwy zgrzewane ultradźwiękowo. Rozmiar 110x210 cm. I klasa palności, niepalący (pylenie ≤1,9_{log10}). Produkt higieniczny o podwyższonej czystości mikrobiologicznej. Producent spełnia wymogi Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485 oraz normy środowiskowej ISO14001 potwierdzone certyfikatami. Próżniowe opakowanie jednostkowe minimalizujące zajmowaną powierzchnię, opakowanie zbiorcze karton zawierający 30 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 10 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści poszwę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o składzie: warstwy zewnętrzne wykonane z włókny polipropylenowej 25g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 6 - Czy Zamawiający zgodzi się na odstępnie od wymogu normy 13795:2011?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 11:

Pakiet 11 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę sterylnych przyrządów do zdejmowania ostrzy skalpela pakowanych a'50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 14:

Pakiet 14

Poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający ma na myśli: Cewnik moczowodowy zakończeniem Couvelaire , rozmiar CH5 do CH8 a nie jak jest w formularzu ch 88?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Pakietu nr 15:

1. Pakiet 15

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kateteru do nefrostomii:

W poz. 1) Rozmiar 6 FR x 26 cm zamiast 5 FR x 25cm

W poz. 2) dl. 26 cm zamiast 25 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15 kateterów do nefrostomii przezskórnej typu Pigtail w rozmiarach:

Poz. 1) 6 FR x25cm z kompatybilnym trokarem 19G

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 2) 8 FR x25cm z kompatybilnym trokarem 17G

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 17:

Czy Zamawiający dopuści w ureterorenoscop z bocznie przesuniętą częścią oczną średnica: dystalna 7,5 Fr. do pierwszego stopnia 9,8 Fr. długość robocza 430mm kierunek widzenia 8°, pole widzenia 85° szeroki kąt zintegrowany kanał roboczy dla narzędzi 5 Fr. w tym odłączany mostek instrumentalny z 2 kranami (wlot/wylot)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 18:

1. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie zaworu biopsyjnego do narzędzia sondy o maksymalnym rozmiarze 9 Fr. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 19:

Pyt. 1 pkt 1

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie okularów ochronnych RTG, ochrona przednia Pb min. 0.75mm, boki 0,5mmPb, zakładanych na okulary korekcyjne, o maksymalnym ciężarze 92g w **ilości 2 sztuk**?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pyt. 2 pkt 2

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie okularów ochronnych RTG, ochrona przód i boki 0,75 mmPb, wykonane z elastycznego nylonu, aby zminimalizować ryzyko złamania. Okulary z mostkiem siodełkowym równomiernie rozkładające ciężar na nosie. Boczne osłony z ołowianego szkła, waga 90g w **ilości 5 sztuk**?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 19 poz. 1 zaoferowania okularów ochronnych typu gogle o następujących cechach: możliwość regulacji kąta nachylenia i długości ramion pozwalają na dokładne dopasowanie okularów do twarzy co zapewnia optymalną ochronę. Wielkość i kształt oprawek umożliwiają ich stosowanie na zwykłe okulary korekcyjne. Ochrona przednia i boczna Pb 0.75mm, zauszniki anatomiczne z powłoką antyślizgową, ciężar 101g, Kolor: przezroczysty dyminy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 19 poz. 2 zaoferowania okularów ochronnych typu panoramiczne o następujących cechach: zapewniają szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szklom ochronnym. Oprawki wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Szczególna elastyczność tworzywa zmniejsza szansę pęknięcia lub złamania oprawek. Mostek zapewniający równomierne rozłożenie ciężaru na nosie. Ochrona przednia i boczna Pb 0.75mm, ciężar 90g, Kolor: rogowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy pakietu nr 19

1. Bardzo prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 19, pozycji 1 model okularów fitover, który reprezentujemy w załączniku, a który posiada komfortową, lekką trwałą konstrukcję z dodatkową ochroną czoła, wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. wielkość oprawki pozwala na pokrycie korygujących okularów użytkownika. dzięki ruchomej konstrukcji ramion zauszników, okulary są łatwe do dopasowania do potrzeb użytkownika. okulary posiadają standardowe szkła ochronne o ekwiwalencie ołowiu 0,75 mm (przód i boki) .okulary są wyposażone w pasek na szyję zabezpieczający przed spadnięciem okularów. waga: 86g

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. w pozycji 2, prosimy zamawiającego o dopuszczenie okularów, które również reprezentujemy w załączeniu . są to okulary rtg, które są wykonane z wysokiej jakości odmiany nylonu tr-90 wyjątkowo odpornego na rozciąganie i wyginanie. materiał jest bardzo elastyczny, przyjemny w dotyku oraz posiada właściwości antyalergiczne. okulary posiadają standardowe szkła ochronne schott sf-6 o ekwiwalencie ołowiu 0,75 mm oraz zabezpieczenie boczne o ekwiwalencie ołowiu 0,35 mm. końce zauszników pokryte są miękkim materiałem gumowym w celu zapewnienia przyczepności i komfortu użytkowania a noski/nanośniki posiadają miękkie wymienne wkładki dostępne w trzech rozmiarach. waga: 70g z poważaniem

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 20:

Pakiet 20 Ochrona RTG

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie fartucha miednicowego – ochrona pacjenta, wymiary 50x50cm, równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 20 w postępowaniu DA.ZP.242.68.2022.

1. Czy w punkcie 2 Zamawiający wyraża zgodę na fartuchy bez nylonowych wstawek? Elementy te nie wpływają na komfort w noszeniu fartucha i sprawiają kłopot w czyszczeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy w punkcie 3 Zamawiający wyraża zgodę na kamizelki zapinane za pomocą nakładających się paneli przednich zapinanych na rzep bez pasa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Czy w punkcie 4 Zamawiający wyraża zgodę na kamizelki zapinane za pomocą nakładających się paneli przednich zapinanych na rzep bez pasa?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

4. Czy w punkcie 5 Zamawiający wyraża zgodę na fartuch zapinany z przodu na rzepy i jeden elastyczny pas?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5. Czy w punkcie 6 Zamawiający wyraża zgodę na fartuch zapinany z przodu na rzepy i jeden elastyczny pas?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Czy w punkcie 7 Zamawiający wyraża zgodę na regał ze stali, ale nie kwasoodpornej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 28:

Pakiet 28

Poz.1

Czy zamawiający ma na myśli Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25x41cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Wyrób medyczny klasa Is.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie maty magnetycznej na narzędzia w nieznacznie różniącym się rozmiarze 51 x 41 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 31:

Pytanie Nr 1 Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 2 .

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 104cm x 188cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 2 .

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 104cm x 230cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Sterylna, Osłona ramienia C w rozmiarze 105x188 cm ± 1 z elastyczną gumką na jednym z końców, trzema zintegrowanymi taśmami lepnyymi do mocowania, wykonana z przezroczystej folii PE. Wyrób medyczny klasy I s. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy, zbiorczo pakowane po 20 szt./ karton. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Sterylna, uniwersalna, jednoczęściowa, **osłona ramienia C mini** wykonana z folii PE, utrzymywana na miejscu za pomocą elastycznej gumki z tyłu oraz trzech przyklepanych pasków do mocowania. Rozmiar 137x216cm, długość pasków min.45cm. Osłona posiada 10 piktogramów pozwalających na intuicyjne zamocowanie na sprzęcie. Opakowanie jednostkowe- rozrywana torebka papierowo foliowa zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: worek foliowy zawierający 20 szt osłon, następnie karton.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31 pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie oczekiwanych wymiarów osłony na kamerę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31 pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzyczęściowego zestawu na ramię C zawierającego:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm, zakończona elastyczną gumką
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm, zakończona elastyczną gumką
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 32:

Pakiet nr 32, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rurki dostępne w rozmiarach od 6,0mm do 9,5mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 35:

Pakiet 35

Dotyczy pozycji 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rur rozciąganych dł. 90-300 cm, średnicy 22 mm, worek oddechowy o pojemności 2l.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy pozycji 3 Prosimy Zamawiającego o informację, do jakiego ogrzewcza plynów dedykowany ma być wymagany dren. Prosimy o doprecyzowanie w celu zapewnienia optymalnego i bezpiecznego transferu ciepła.

Odpowiedź: Blood & Infusion Warner Biegler.

Dotyczy pozycji 4 Prosimy Zamawiającego o informację, jakiej klasy produktu wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Klasa 1a

Dotyczy Pakietu nr 37:

Dotyczy Pakietu nr 37

1. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis „wyrób medyczny dedykowany do ogrzewacza Mistral Air potwierdzony dokumentem producenta” dotyczy producenta urządzenia?

Odpowiedź: Wyrób medyczny potwierdzony dokumentem producenta o kompatybilności do ogrzewacza Mistral Air.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koców w postaci zamienników nie wskazanych wprost w instrukcji obsługi urządzenia Mistral-Air? Ze względu na klasę wyrobu medycznego IIb użytkownik powinien wprost zadeklarować wzięcie odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje użytkowania urządzenia w inny sposób niż przewiduje to producent.

Odpowiedź: Dopuszczamy zamiennik posiadający dokument producenta o kompatybilności do ogrzewacza Mistral Air.

Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach 227 x 133 cm, dedykowanego do urządzenia Mistral, ze sztywnym oraz idealnie dopasowanym do wylotu przewodu grzewczego złączem o średnicy 56-68mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach 201 x 76 cm, dedykowanego do urządzenia Mistral, ze sztywnym oraz idealnie dopasowanym do wylotu przewodu grzewczego złączem o średnicy 56-68mm, przy zachowaniu pozostałych wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 37 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści koc na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm? Koc wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 37 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koc na górną część ciała o wymiarach 202 cm x 64 cm? Koc wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 37 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koc na górną część ciała o wymiarach 202 cm x 80 cm? Koc wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 37 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koc na górną część ciała o wymiarach 230 cm x 100 cm? Koc wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 41:

Pytania do pakietu 41

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści produkty o tej samej lub lepszej funkcjonalności, lecz niewielkich różnicach technicznych podanych w nawiasach:

Pozycja 1 Czterokanalowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm (**proponujemy długość 15cm**) lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nityniowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. (**skład zestawu dla oferowanego cewnika: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką dyrofilną 8fr x 11cm aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania dozowanie drutu prowadzącego nie dotyczy wysokiej jakości z kulką dla dodatkowej kontroli przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe nr. 11 standardowy skalp**) Kontrastujący w promieniach RTG

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pozycja 2 Czterokanalowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowany aktywnym srebrem(**impregnowany poliheksametylenem biguanidu (PHMB)**), który zapobiega adhezji płytek krwi, zmniejszając możliwość rozwoju bakterii. Dodatkowo naładowane wiązanie antybakteryjne przyciąga i niszczy bakterie, które wchodzi w kontakt z wewnętrzną i zewnętrzną stroną cewnika, zapewnia ochronę pacjenta przez cały okres eksploatacji cewnika), sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm(**proponujemy długość 15cm**) lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nityniowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych o prostym torze przepływu do każdego kanału. (**skład zestawu dla oferowanego cewnika: igła echogeniczna 18G x 7,0 cm końcówka**

echnogeniczna dla poprawy widzenia w USG, rozszerzacz z powłoką dyrofilną 8fr x 11cm aktywowany solą fizjologiczną w celu zmniejszenia tarcia podczas wkładania dozowanie drutu prowadzącego nie dotyczy wysokiej jakości z kulka dla dodatkowej kontroli przewodnik nitinolowy o średnicy 50cm x 0,035 nitinol nie stalowy - dzięki temu nie załamuje się u pacjenta strzykawka prowadząca 5CC umożliwia przejście przewodnika przez strzykawkę skrzydło do mocowania wtórnego 2 szt. standardowe nr. 11 standardowy skalp) Kontrastujący w promieniach RTG

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Wykonawca zaproponował produkt równoważny. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o czytelne wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP, tak aby było możliwe określenie, jakie parametry bądź właściwości danego produktu są równoważne, i aby wykonawca mógł w należyty sposób udowodnić, wspomnianą równoważność. Obowiązek formułowania kryteriów oceny równoważności korzystnie wpłynie na przejrzystość postępowania i na równe traktowanie wykonawców w procesie udzielania zamówienia publicznego

Odpowiedź: Zamawiający w Rozdziale 27 SWZ opisał zasady równoważności.

Pakiet 41:

Pozycja 1: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości cewnik centralny ARROW czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 8.5 F-16G,14G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/6,35cm, strzykawki 5ml z otworem w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, Kontrastujący w promieniach RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pozycja 2: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości cewnik centralny ARROW czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, posiadający lepszą powłokę wykonaną z sulfadiazyny srebra oraz chlorcheksydy, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 8.5 F-16G,14G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/6,35cm, strzykawki 5ml z otworem w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, Kontrastujący w promieniach RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 44:

Pytanie nr 1 pakiet 44 pkt.1,2,3

Czy Zamawiający wydzieli z w/w pakietu poz. 2 i 3, tym samym pozwoli zaoferować rękojeści (pkt.2) oraz łyżki laryngoskopowe (pkt.3) o następujących parametrach:

Łyżki nieodkształcające się - wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Posiadające haczyk zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, z zatrzaskiem kulkowym typu "click". Plastikowa podstawa z wytłoczonym rodzajem i rozmiarem łyżki. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym.

Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło.

Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu (przekreślona cyfra 2), pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 3 lata. Łyżki Macintosh o rozmiarach 0;1;2;3;5;4;5, Miller 000;00;0;1;2;3;4;5.?

Rękojeść do łyżek światłowodowych, jednorazowa, dostępna w dwóch rozmiarach standardowym i małym,

Compact 120mm x 29mm

Medium 139mm x 33mm

· wbudowane źródło zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło pakowana w folię z oznaczeniem numeru katalogowego, symbolami CE oraz „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2),

- wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 (zielony standard) z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym
- Fabrycznie zamontowana bateria alkaliczna, łatwa do szybkiego usunięcia do bezpiecznej utylizacji.
- Metalowe uchwyty połączeniowe z łyżkami, zapewniają możliwość intubacji z wielką siłą.
- Mocne, jasne źródło światła LED zapewnia doskonale oświetlenie ze średnią wydajnością 11 000 luksów w odległości 2 cm.
- bez zawartości lateksu.

Łyżki nieodkształcające się - wykonane z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Posiadające haczyk zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, z zatraskiem kulkowym typu "click". Plastikowa podstawa z wytłoczonym rodzajem i rozmiarem łyżki. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym.

Światłowod wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło.

Światłowod nieosłonięty, doświetlający wnętrza jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol świadczący o jednorazowym zastosowaniu wyrobu (przekreślona cyfra 2), pakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 3 lata. Łyżki Macintosh o rozmiarach 0;1;2;3;5;4;5; Miller 000;00;0;1;2;3;4;5.?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet nr 44, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	DOTYCZY ETT
CH06	255 mm	2.5-4.5 mm
CH10	340 mm	4.0-6.0 mm
CH12	340 mm	5.5-6.5 mm
CH14	340 mm	5.5-10.0 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rękojeść z zielonym ringiem pod mocowaniem łyżki z uchwytem (zamiast czopu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rękojeść plastikowo-metalową, gdzie część chwytu wykonana jest z plastiku w kolorze zielonym, z poprzecznymi lub podłużnymi frezami?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści łyżki z plastikowym mocowaniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści datę ważności 3 lata?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 3 – Czy zamawiający odstąpi od parametru „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym – potwierdzenie od producenta”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki bez podwiniętej końcówki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki skalowane co 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki z pojedynczym okiem Murphiego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki z opakowaniem bez informacji o średnicy wypełnionego mankietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierzni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rurki bez podwiniętej końcówki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rurki skalowane co 1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rurki z pojedynczym okiem Murphiego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rurki z opakowaniem bez informacji o średnicy wypełnionego mankietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci 2 półpierzni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści rurki bez podwiniętej końcówki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści rurki z pojedynczym okiem Murphiego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 44, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści rurki z opakowaniem bez informacji o średnicy wypełnionego mankietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 44 Dotyczy pozycji 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy zapisów Projektu umowy:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Dot. zał. nr 8.1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

2) 0,1 % wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1;**

3) 0,5 % wartości Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w:

a) § 3 ust. 2,

b) § 3 ust. 10 pkt 1,

c) § 3 ust. 10 pkt 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Towarów objętych Zamówieniem.**

4) 10 % **niezrealizowanej** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

2. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 10 (zał. nr 8.1) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie E-FAKTUR za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Numer PEPPOL NIP 5422529292. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

4. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 8.1 do SWZ), paragraf 3, ustęp 10, podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

5. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 8.1 do SWZ), paragraf 3, ustęp 10, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostarczenie towaru wolnego od wad do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

Zmiana SWZ:

W związku z udzielonymi odpowiedziami **na pytanie 4 oraz 5** ulegają zmianie zapisy paragraf 3, ustęp 10, podpunkt 1 oraz podpunkt 2 .

Otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się:

- 1) uzupełnić stwierdzone przez Zamawiającego braki ilościowe w otrzymanym Towarze w terminie do 3 dni roboczych;
- 2) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych, a następnie w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, dostarczenia Towaru wolnego od wad.“

6. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 8.1 do SWZ), paragraf 7, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby maksymalna łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

.....

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ są wiążące dla wszystkich
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA:

W związku z nieudzieleniem wyjaśnień SWZ w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana SWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma**